

คู่มือการใช้งานระบบ STENT PROJECT สำหรับหน่วยบริการ

ระบบ STENT จะอยู่ภายใต้ระบบ MDS ขององค์การเภสัชกรรม โดยเข้าผ่าน URL: <http://mds.gpo.or.th>

1. เข้าสู่ระบบ

เมื่อเปิดเว็บไซต์เข้ามาหน้าแรก จะประกอบไปด้วย

- ส่วนของการ Login เข้าสู่ระบบตามที่ Username และ Password ที่ท่านได้รับ
- หน้าเพจข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ของ อภ. สปสช. และบริษัทผู้จำหน่าย ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- หน้าเพจสำหรับดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด



GPO-MDS
MEDICAL DEVICE STOCK

User Name:

Password:

Login

Remember Login

[Register](#)
[Forgot Password ?](#)

 ข้อมูลการติดต่อ  ดาวน์โหลดเอกสาร

Copyright © 2009 The Government Pharmaceutical Organization (GPO), Bangkok, Thailand

2. เลือกโครงการ


เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ MDS มาแล้วจะเข้าสู่หน้าจอโครงการต่างๆที่อยู่ในระบบ และท่านจะมีสิทธิ์ใช้งานตามโครงการที่ได้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ให้คลิกเลือกโครงการ STENT



3. ดูรายการการใช้ STENT

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนู รายการการใช้งาน STENT เพื่อดูรายการ STENT ที่หน่วยบริการเบิกใช้เข้ามาในระบบ



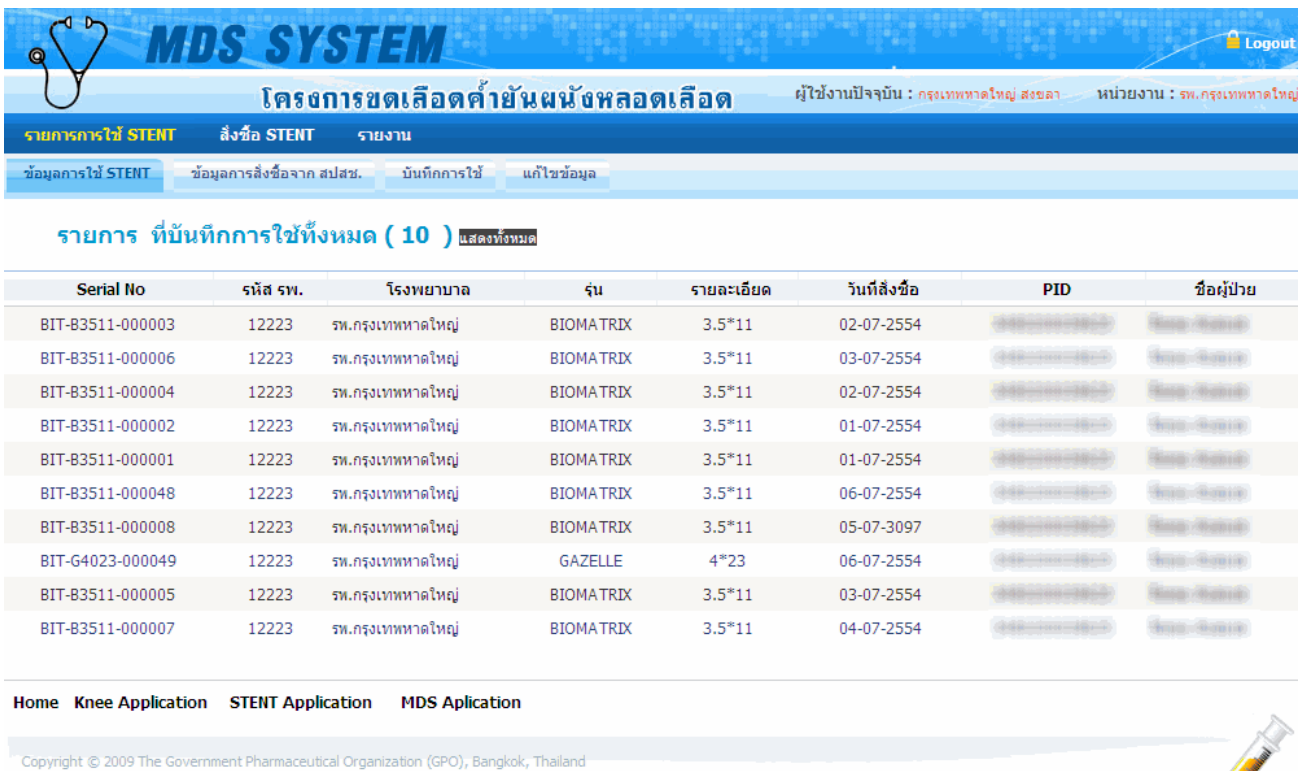

รายการ ที่บันทึกการใช้ทั้งหมด (10) แสดงทั้งหมด

Serial No	รหัส รพ.	โรงพยาบาล	รุ่น	รายละเอียด	วันที่สั่งซื้อ	PID	ชื่อผู้ป่วย
BIT-B3511-000003	12223	รพ.กรุงเทพมหานครใหญ่	BIOMATRIX	3.5*11	02-07-2554		
BIT-B3511-000006	12223	รพ.กรุงเทพมหานครใหญ่	BIOMATRIX	3.5*11	03-07-2554		
BIT-B3511-000004	12223	รพ.กรุงเทพมหานครใหญ่	BIOMATRIX	3.5*11	02-07-2554		
BIT-B3511-000002	12223	รพ.กรุงเทพมหานครใหญ่	BIOMATRIX	3.5*11	01-07-2554		
BIT-B3511-000001	12223	รพ.กรุงเทพมหานครใหญ่	BIOMATRIX	3.5*11	01-07-2554		
BIT-B3511-000048	12223	รพ.กรุงเทพมหานครใหญ่	BIOMATRIX	3.5*11	06-07-2554		
BIT-B3511-000008	12223	รพ.กรุงเทพมหานครใหญ่	BIOMATRIX	3.5*11	05-07-3097		
BIT-G4023-000049	12223	รพ.กรุงเทพมหานครใหญ่	GAZELLE	4*23	06-07-2554		
BIT-B3511-000005	12223	รพ.กรุงเทพมหานครใหญ่	BIOMATRIX	3.5*11	03-07-2554		
BIT-B3511-000007	12223	รพ.กรุงเทพมหานครใหญ่	BIOMATRIX	3.5*11	04-07-2554		


Home Knee Application STENT Application MDS Application

Copyright © 2009 The Government Pharmaceutical Organization (GPO), Bangkok, Thailand

- ข้อมูลการใช้ STENT คือ หน้าข้อมูลการใช้ที่หน่วยบริการบันทึกเข้ามาทั้งหมด
- ข้อมูลการสั่งซื้อจาก สปสช. คือ ข้อมูลที่หน่วยบริการบันทึกเข้าไปในระบบและได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจาก สปสช. แล้ว
- บันทึกการใช้ คือ หน้าจอบันทึกการใช้ STENT
- แก้ไขข้อมูล คือ หน้าจอการแก้ไขข้อมูลการใช้ที่บันทึกผิดพลาด


4. บันทึกการใช้งาน

ในการบันทึกการใช้จะใช้การสแกนอ่านบาร์โค้ดบนสติ๊กเกอร์ข้างกล่องเลนส์ ดังนั้นหลังจากใช้เลนส์ให้เก็บกล่องไว้เพื่อบันทึก Serial No ลงในระบบ โดยลักษณะของ บาร์โค้ด Serial No บนสติ๊กเกอร์ มีดังลักษณะดังนี้

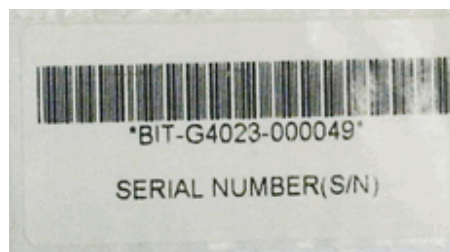

Serial No คือ BIT-G4023-000049 (ไม่รวมเครื่องหมาย *)

การบันทึกการใช้ทำได้โดยการเลือกเมนู **สั่งซื้อ STENT**---> บันทึกการใช้ จากนั้นให้กรอกข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วนทุกช่อง และตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยให้เรียบร้อย จากนั้นให้วางเครื่องเซอร์ไว์ที่ช่อง **Serial Number** แล้วทำการอ่าน **Serial No** จากบาร์โค้ดบนสติ๊กเกอร์ของเลนส์ที่ใส่ไป หรือ หากไม่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดให้ทำการ พิมพ์ **Serial No** ให้ครบทุกตัวอักษรและถูกต้องตามรูปแบบบนสติ๊กเกอร์ จากนั้นกดบันทึกการใช้งาน

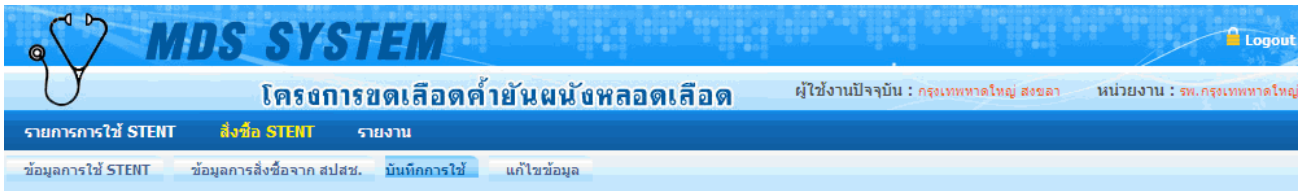

บันทึกการใช้ STENT

Hospital Code PID

HN ชื่อคนไข้

AN อายุ

วันที่ผ่าตัด (dd-mm-yyyy(พ.ศ.)) สิทธิที่ได้รับ

Serial Number

ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนและกรอก Serial No. จากนั้นกดปุ่มบันทึกการใช้งาน


รายการ ที่ถูกใช้ (10) (รายการที่บันทึกการใช้อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

Serial No	PID	ชื่อคนไข้	รุ่น	Description	วันที่ผ่าตัด	วันที่สั่งซื้อ
BIT-B3511-000007	5480200039625	ธีระพล ต้นสมรส	BIOMATRIX	3.5*11	04-07-2554	04-07-2554
BIT-B3511-000006	5480200039625	ธีระพล ต้นสมรส	BIOMATRIX	3.5*11	03-07-2554	03-07-2554
BIT-B3511-000008	5480200039625	ธีระพล ต้นสมรส	BIOMATRIX	3.5*11	05-07-3097	05-07-3097
BIT-G4023-000049	5480200039625	ธีระพล ต้นสมรส	GAZELLE	4*23	06-07-2554	06-07-2554
BIT-B3511-000048	5480200039625	ธีระพล ต้นสมรส	BIOMATRIX	3.5*11	06-07-2554	06-07-2554
BIT-B3511-000002	5480200039625	ธีระพล ต้นสมรส	BIOMATRIX	3.5*11	01-07-2554	01-07-2554
BIT-B3511-000001	5480200039625	ธีระพล ต้นสมรส	BIOMATRIX	3.5*11	01-07-2554	01-07-2554
BIT-B3511-000003	5480200039625	ธีระพล ต้นสมรส	BIOMATRIX	3.5*11	02-07-2554	02-07-2554
BIT-B3511-000005	5480200039625	ธีระพล ต้นสมรส	BIOMATRIX	3.5*11	03-07-2554	03-07-2554
BIT-B3511-000004	5480200039625	ธีระพล ต้นสมรส	BIOMATRIX	3.5*11	02-07-2554	02-07-2554

เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายการ STENT ที่บันทึกจะแสดงในตารางรายการที่ถูกใช้ด้านล่าง ถือว่าการดำเนินการบันทึกการใช้งานเสร็จสมบูรณ์

5. แก้ไขข้อมูล

แก้ไขกรณีบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผิด ให้เลือกเมนู แก้ไขข้อมูล

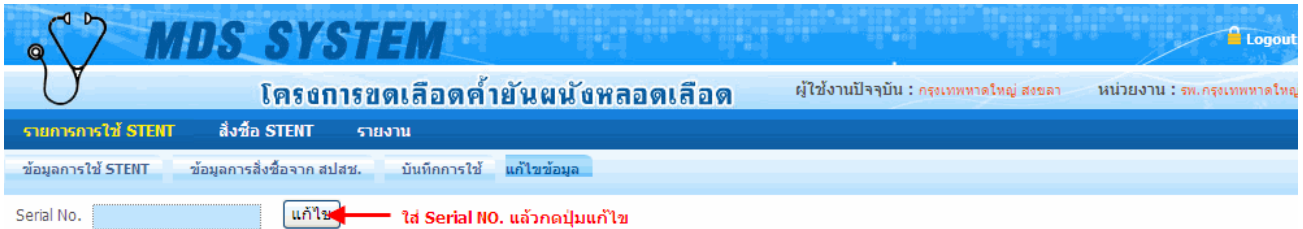

The screenshot shows the MDS SYSTEM interface with the following elements:

- Header: MDS SYSTEM, Logout
- Page Title: โครงการขดเลือดต้านผนังหลอดเลือด
- User Info: ผู้ใช้งานปัจจุบัน : กรุงเทพมหานคร สงขลา, หน่วยงาน : รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
- Navigation: รายการการใส่ STENT, สิ่งชื่อ STENT, รายงาน
- Menu: ข้อมูลการใส่ STENT, ข้อมูลการสิ่งชื่อจาก สปสช., บันทึกการใส่, **แก้ไขข้อมูล**
- Form: Serial No. [] **แก้ไข** (with a red arrow pointing to the button), ใส่ Serial NO. แล้วกดปุ่มแก้ไข

อ่านข้อมูล Serial No. จากสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด หรือ ป้อนจากแป้นพิมพ์เอง จากนั้นกดปุ่มแก้ไข



The screenshot shows the MDS SYSTEM interface with the following elements:

- Header: MDS SYSTEM, Logout
- Page Title: โครงการขดเลือดต้านผนังหลอดเลือด
- User Info: ผู้ใช้งานปัจจุบัน : กรุงเทพมหานคร สงขลา, หน่วยงาน : รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
- Navigation: รายการการใส่ STENT, สิ่งชื่อ STENT, รายงาน
- Menu: ข้อมูลการใส่ STENT, ข้อมูลการสิ่งชื่อจาก สปสช., บันทึกการใส่, **แก้ไขข้อมูล**
- Form:
 - Hospital Code 12223
 - HN 187415
 - AN 721d5
 - วันที่ผ่าตัด 06-07-2554 * ปกติ (dd-mm-yyyy(พ.ศ.))
 - PID 5480200039625 [ตรวจสอบสิทธิ์]
 - ชื่อคนไข้ ชีระพล ดันสมรส
 - อายุ
 - สิทธิ์ที่ได้รับ
- Buttons: บันทึกการแก้ไข, ยกเลิก
- Footer: บันทึกความต้องการโดย, สถานะใบบันทึกความต้องการ, บันทึกการใช้อุปกรณ์, วันที่บันทึก 06 กรกฎาคม 2554

ใส่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำการบันทึกการแก้ไข

6. รายงานการใช้ STENT

คลิกเลือกเมนูรายงาน ---> การใช้ STENT ตาม หน่วยบริการ



จากนั้นเลือกเงื่อนไขในช่วงวันที่ต้องการดูรายงาน และกด View Report



รายงานสรุปการใช้ STENT แยกตามหน่วยบริการ

สามารถดูรายงานได้เฉพาะหน่วยบริการของ user เท่านั้น

หน่วยบริการ:

วันที่: ปัดขึ้น ถึง ปัดขึ้น

เลือกช่วงวันที่ แล้วกดปุ่ม View Report

คลิกปุ่ม Export หากต้องการพิมพ์หรือส่งออกเป็น Excel

Serial No.	บริษัท	ชนิด	ชื่อสินค้า	ชุดสินค้า	OrderDate
F2513	บริษัท ไทยโอซูซ่า จำกัด	เคสiox	2.5 x 13 mm	FIREBIRD	28-12-2553
F2533	บริษัท ไทยโอซูซ่า จำกัด	เคสiox	2.5 x 33 mm	FIREBIRD	28-12-2553
BMXT-2211	บริษัท ไพร้ม เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด	เคสiox	BioMatrix 2.25 x 11 mm	BIOMATRIX	21-12-2553
BMXT-2211	บริษัท ไพร้ม เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด	เคสiox	BioMatrix 2.25 x 11 mm	BIOMATRIX	28-12-2553
BMXT-2208	บริษัท ไพร้ม เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด	เคสiox	BioMatrix 2.25 x 8 mm	BIOMATRIX	28-12-2553
GAZ-2508	บริษัท ไพร้ม เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด	ไม่เคสiox	Gazelle 2.5 x 8 mm	GAZELLE	28-12-2553

Home MDSsystem Download ContactList

Copyright © 2010 The Government Pharmaceutical Organization (GPO), Bangkok, Thailand

หากต้องการ Print หรือ Export ออกไปยัง Microsoft Excel ให้เลือกกดที่ปุ่ม export และจะปรากฏหน้าต่างรายงานสำหรับพิมพ์และ Export

ถ้าหากคลิกแล้วไม่ปรากฏหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาใหม่ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการ **Popup Blocker** อยู่ให้แก่ไขปัญหา
ก่อน โดยทำการปิด **Popup Block** และทำการกำหนด **Trust site** ซึ่งวิธีการกำหนด **Trust Site** ให้ไปอ่านที่คู่มือการกำหนด **Trust site** หรือ เรียกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการให้มาทำการตั้งค่าให้

รายงานข้อมูลการใช้ตามหน่วยบริการ
รพ.ทดสอบระบบ

พิมพ์ออกทางเครื่อง print [ที่นี่](#)

Serial No.	บริษัท	ชนิด	ชื่อ	ชุดสินค้า	OrderDate
F2513	บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด	เคลือบยา	2.5 x 13 mm	FIREBIRD	28-12-2553
F2533	บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด	เคลือบยา	2.5 x 33 mm	FIREBIRD	28-12-2553
BMXT-2211	บริษัท ไพร้ม เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด	เคลือบยา	BioMatrix 2.25 x 11 mm	BIOMATRIX	21-12-2553
BMXT-2211	บริษัท ไพร้ม เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด	เคลือบยา	BioMatrix 2.25 x 11 mm	BIOMATRIX	28-12-2553
BMXT-2208	บริษัท ไพร้ม เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด	เคลือบยา	BioMatrix 2.25 x 8 mm	BIOMATRIX	28-12-2553
GAZ-2508	บริษัท ไพร้ม เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด	ไม่เคลือบยา	Gazelle 2.5 x 8 mm	GAZELLE	28-12-2553

[Export](#) ← **Export ไปยัง Ms Excel**

เมื่อคลิกปุ่ม **Export** ระบบจะถามให้เปิดหรือบันทึกดังกล่าว

